

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Уход за UreSil® Thora-Vent™

Эта информация поможет вам понять, как ухаживать за системой UreSil Thora-Vent.

Информация о системе Thora-Vent

Система Thora-Vent (также известная как система грудного дренажа) — это небольшое устройство, которое крепится к грудной клетке. Оно состоит из одностороннего клапана с самозакрывающимся портом и небольшого катетера (тонкой гибкой трубки), который отводит лишний воздух из грудной клетки, что позволяет легким полностью раскрыться. Система крепится к вашей грудной клетке с помощью липких «крылышек». Для ее удержания на месте вам также могут наложить кетгут (шов). Вас могут выписать домой с установленной системой Thora-Vent, если утечка воздуха продолжается 7 дней или больше.

Компоненты системы

Система грудного дренажа состоит из 2 частей: камеры и липких «крылышек» (см. рисунок 1).

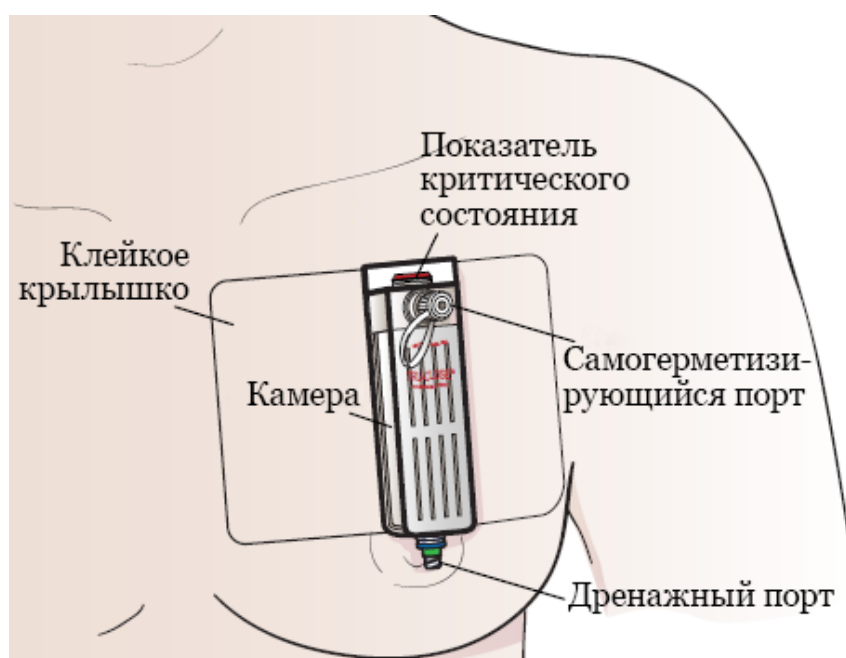


Рисунок 1. Система Thora-Vent

Камера является главной составляющей системы дренажа. Внутри нее находится красная сигнальная диафрагма, которая сообщает медицинскому сотруднику о состоянии вашего легкого. Если диафрагма остается опущенной в течение 1 часа или дольше, возможно, ваше легкое полностью расширилось. Если это произойдет, сообщите своему медицинскому сотруднику.

Два липких «крылышка» расположены по обе стороны камеры и удерживают ее на месте (см. рисунок 1).

Как ухаживать за системой Thora-Vent

- Ваша система Thora-Vent должна напрямую касаться вашего тела. Катетер (трубочку) не должно быть видно даже частично. Если катетер виден, немедленно позвоните своему медицинскому сотруднику.
- Если липкие «крылышки» начали отклеиваться от вашей кожи, закрепите их с помощью лейкопластыря. Не накладывайте пластырь на камеру.
- Ни в коем случае не меняйте положение дренажа и не снимайте его. Если ваш дренаж сместился, немедленно позвоните своему медицинскому сотруднику. Тем временем наложите на место установки дренажа марлевую повязку с Vaseline®, полученную от медсестры/медбрата, а сверху нее наложите чистую сухую марлевую повязку. Прикрепите обе марли к вашей коже с помощью лейкопластыря.
 - Ваш медицинский сотрудник может посоветовать вам обратиться в ближайший пункт неотложной медицинской помощи или в Центр неотложной помощи (Urgent Care Center, UCC) при Memorial Sloan Kettering. Центр неотложной помощи расположен по адресу:

425 East 67th Street (между York Avenue и First Avenue)
New York, NY 10065
- Если через систему дренажа выделяется жидкость, немедленно позвоните своему медицинскому сотруднику.
 - В этом случае вам может понадобиться подсоединить дренаж к дренажному мешку. Чтобы вылить жидкость, откройте клапан в нижней части дренажного приемника и слейте ее в унитаз. В этом случае медицинский сотрудник предоставит вам дополнительную информацию.

Ваш медицинский сотрудник проверит Thora-Vent на следующем приеме в

клинике.

Принятие душа с системой дренажа

Вы можете принимать душ, но дренаж нельзя мочить.

- Накройте ваш дренаж водонепроницаемым пластырем (например, AquaGuard®) перед принятием душа.
- Пользуйтесь душем с гибким шлангом, если он у вас есть. Использование душа с гибким шлангом предотвратит попадание воды на дренаж.

Если на дренаж попало немного воды, промокните его насухо полотенцем. Если вы погрузили свой дренаж в воду, позвоните своему медицинскому сотруднику.

Не принимайте ванну, не пользуйтесь джакузи, не плавайте и не погружайтесь в воду, пока вам не снимут дренаж.

Как использовать водонепроницаемый пластырь AquaGuard

Перед принятием душа закройте систему Thora-Vent водонепроницаемым пластырем AquaGuard в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Следите за тем, чтобы пластырь AquaGuard приклеился к коже, а не к дренажу.

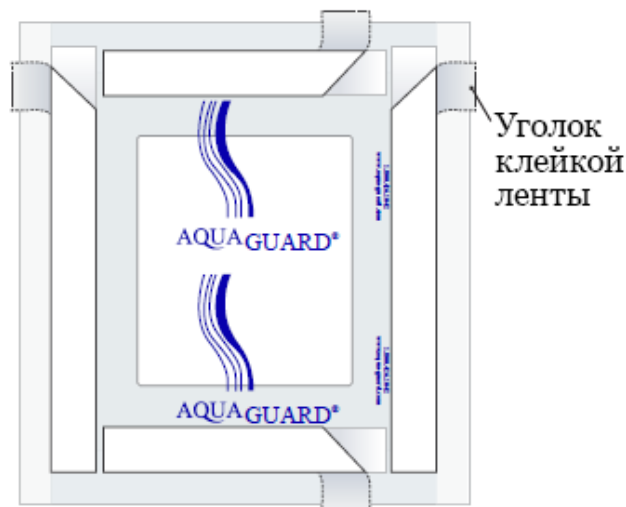


Рисунок 2. Как согнуть съемную ленту на пластыре AquaGuard

1. Убедитесь в том, что кожа вокруг дренажа чистая и сухая.
2. Достаньте водонепроницаемый пластырь AquaGuard из пластиковой упаковки. По краям водонепроницаемого пластыря AquaGuard наклеена съемная лента. Отогните уголок ленты с каждого края (см. рисунок 2).

3. Отклейте верхнюю полосу ленты. Расположите край AquaGuard над дренажом и плотно прижмите, чтобы он прилип к коже
4. Отклейте одну из боковых полосок ленты. Убедитесь, что липкая часть не касается дренажа. Расположите липкий край на коже и плотно прижмите, чтобы он прилип к коже. Если остался излишек материала, сожмите его и отогните в сторону.
5. Повторите шаг 4 с другой стороны пластыря AquaGuard.
6. Повторите шаг 4 с нижней стороны пластыря AquaGuard.
7. Нажмите на каждый край, чтобы убедиться, что пластырь полностью приклеился к коже.

Чтобы снять пластырь AquaGuard, отклейте верхний левый или правый угол и осторожно потяните его вниз. Старайтесь отклеивать пластырь по направлению роста волос. Делайте это осторожно, чтобы не потянуть дренаж.

Физическая нагрузка с системой дренажа

Вы можете выполнять физические упражнения с прикрепленной системой Thora-Vent. Легкие упражнения, такие как ходьба и подъем по лестнице, помогут вам набраться сил и улучшить свое самочувствие.

Вы также можете выполнять дыхательные упражнения, которые помогут вам расширить легкие, например:

- Упражнения, стимулирующие откашливание, и глубокие вдохи. Кто-нибудь из специалистов, осуществляющих уход за вами, научит вас делать эти упражнения.
- Использование стимулирующего спирометра каждые 2 часа во время бодрствования. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с материалом *Как пользоваться стимулирующим спирометром* (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer).
- Использование клапана Asapella или Flutter. Эти устройства помогут удалить слизь, и с ними вам будет легче дышать. Если они вам нужны, ваш медицинский сотрудник закажет их для вас. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с материалом *Как использовать устройство для очистки легких от мокроты Aerobika®* (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/how-use-your-aerobika).

Действия, которых следует избегать при установленной системе Thora-Vent

Соблюдайте эти рекомендации до получения других указаний от медицинского сотрудника:

- не летайте на воздушном транспорте;
- не управляйте автомобилем;
- не поднимайте ничего тяжелее 5 фунтов (2,3 кг);
- не принимайте ванну, не пользуйтесь джакузи, не плавайте и не погружайтесь в воду.

Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если наблюдается что-либо из нижеперечисленного:

- температура тела 101°F (38,3°C) или выше;
- ваш дренаж открепился от кожи;
- вы видите часть катетера, введенного в кожу;
- ваша красная сигнальная диафрагма опущена в течение 1 часа или более;
- дренаж сместился или выпал;
- появилась новая боль в груди или одышка;
- кожа вокруг места ввода системы покраснела, отекла, теплая на ощупь или болит при прикосновении;
- у вас возникла боль, которая не проходит после приема обезболивающего лекарства;
- в ваш дренаж вытекает кровь или другая жидкость;
- у вас возникли вопросы или опасения.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Caring for Your UreSil® Thora-Vent™ - Last updated on May 30, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Дата последнего обновления

May 30, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

Поделитесь своим мнением

Поделитесь своим мнением

Ваш отзыв поможет нам скорректировать образовательные материалы, предоставляемые пациентам. Данные, предоставленные вами в этой форме обратной связи, будут недоступны для сотрудников вашей лечащей команды. Пожалуйста, не используйте эту форму для вопросов о вашем лечении. Если у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Хотя мы читаем все отзывы, мы не можем ответить на все вопросы. Мы просим не указывать свое имя или какую-либо персональную информацию в этой форме обратной связи.

Was this information easy to understand?

Yes

Yes

Somewhat

Somewhat

No

No

Что следует объяснить более подробно?

Не вводите свое имя или любую персональную информацию.

Отправить